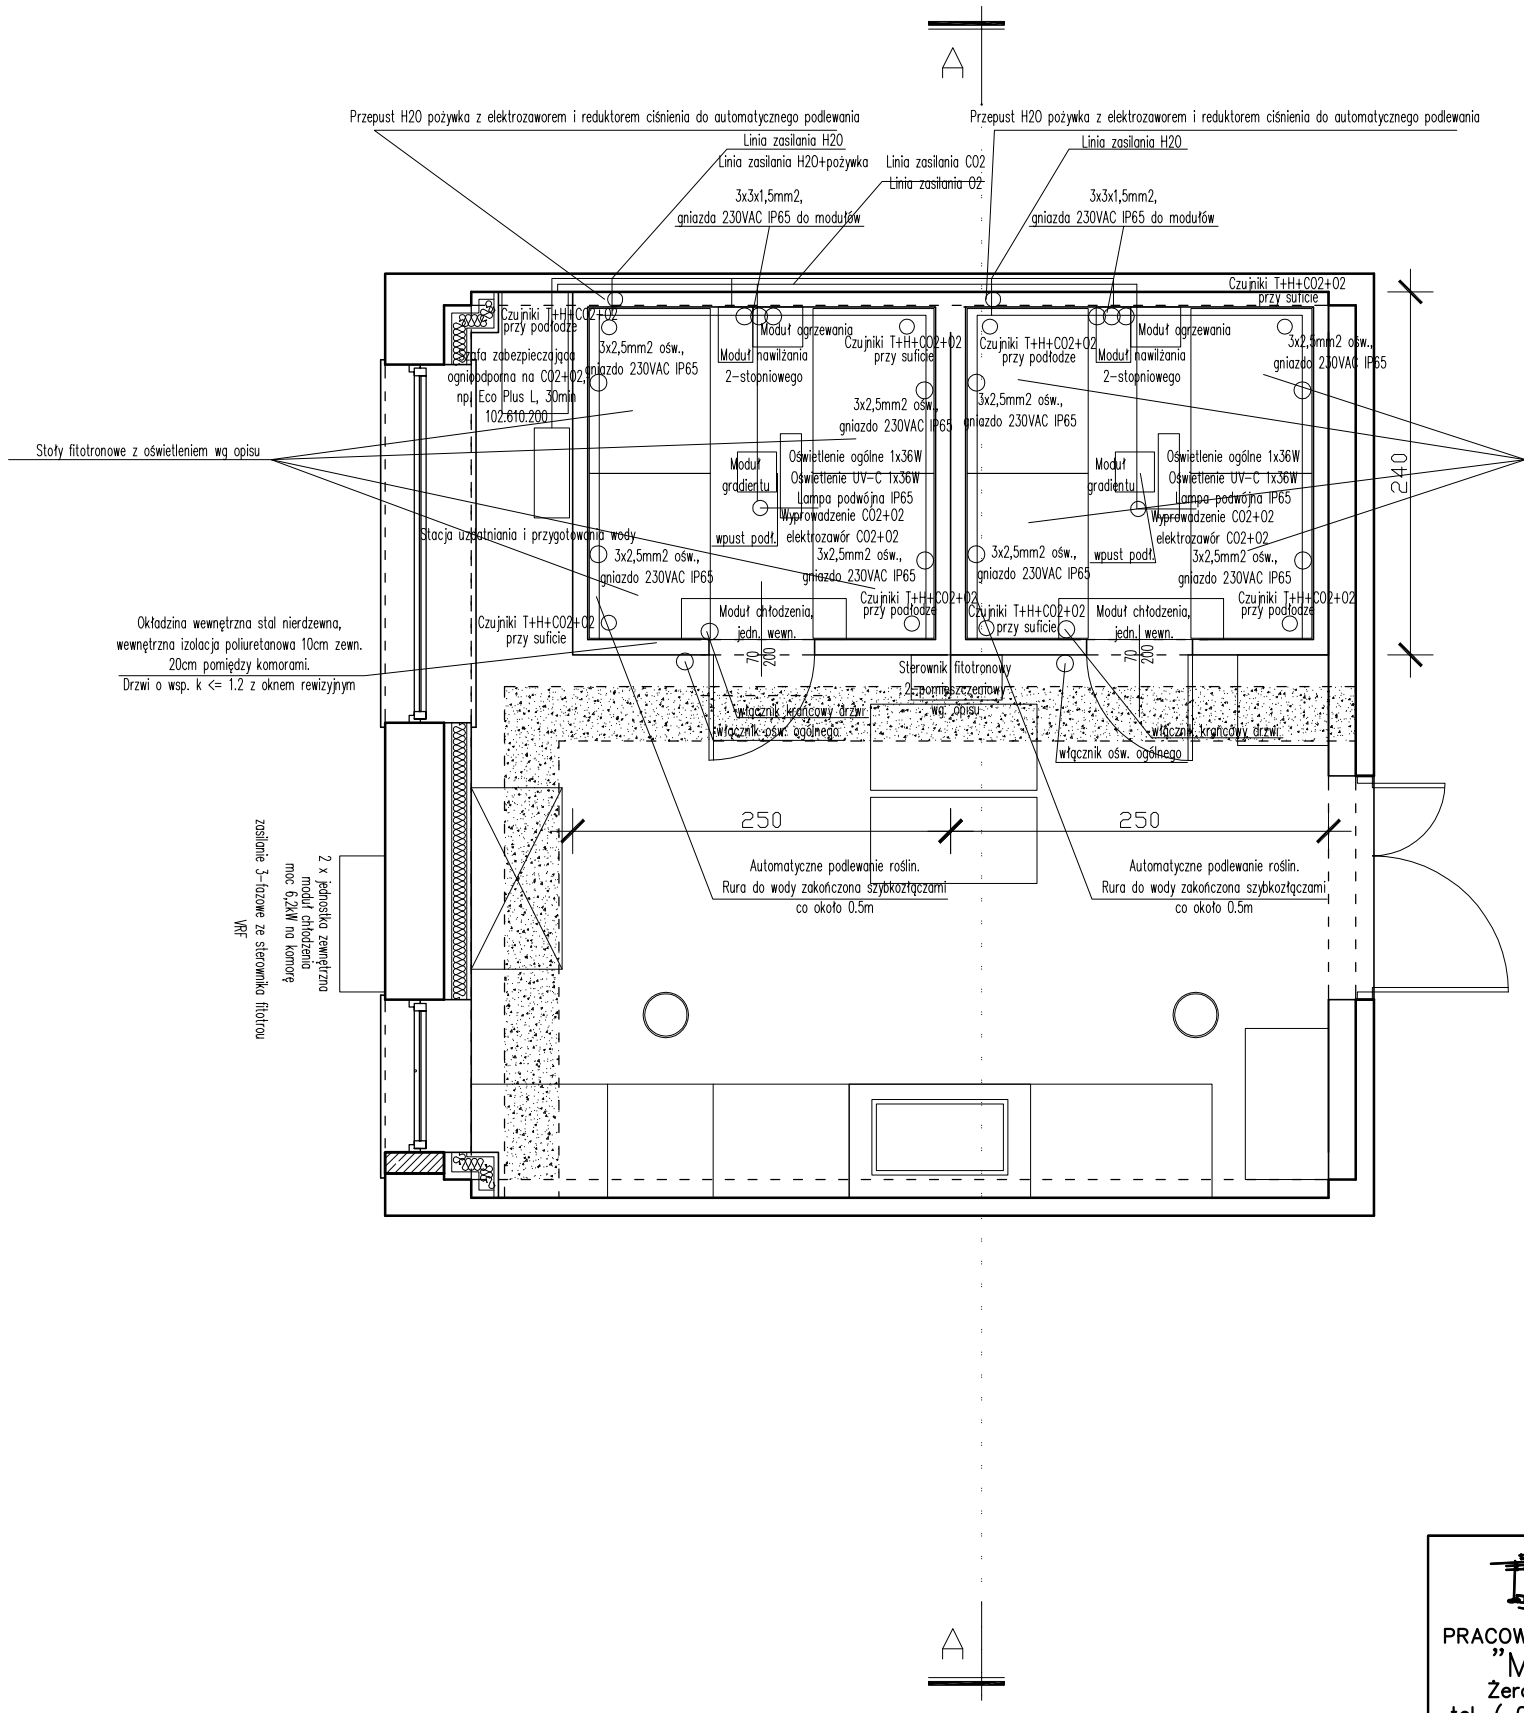

Wyposażenie komory fitotronu i niezbędne urządzenia jak na przedstawionym rysunku.
W komorze przewiduje się oświetlenie ogólne 36W
oraz lampę UVC do sterylizacji włączaną ze sterownika fitpotronowego
Drzwi muszą posiadać wyłącznik krańcowy podłączony do sterownika fitotronowego
Szczegółowy opis elementów komory w opisie projektu.

Zaprojektowano dwie komory o wymiarach 250x240x270cm

Oświetlenie stołów w fitotronach lampami sodowymi i ledowymi

Przewidziano na komorę 4 lampy sodowe I 4 lampy ledowe, doprowadzić moc do każdej lampy 400W
Możliwość wymiany panelu lampy led na lampy sodowe.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MAXPOL" Żeromskiego 51a tel. (048) 385-09-57		imię i nazwisko	nr upr. bud.	data:	podpis:
	projektant:	mgr inż. arch. Jacek Kapusta	UAN-II-K-8386 /137/86	02 2015	
	sprawdzający:				
	opracowanie:	mgr inż. Karol Grysiński		02 2015	
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY					
Obiekt:		Inwestor:			skala:
Modernizacja pomieszczenia laboratoryjnego oraz budowa w tym pomieszczeniu komór chłodniczych ze sterowanym klimatem w budynku fitotronowym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie		Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Radzików 05-870 Błonie			1:50
Adres		Tytuł rysunku:			nr rysunku:
Radzików 05-870 Błonie		TECHNILOGIA WYPOSAŻENIE KOMÓR FITOTRONOWYCH			1/KFT

Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)